



DOO INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE

Bul oslobođenja 30, Novi Sad, Tel; 021 468-636; 021 6371-499

www.instituthib.rs ; office@instituthib.rs

MB: 08803978 PIB: 103183591

Broj i datum izdavanja: **230228-023**
17.02.2023.

Naručilac:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
Dr. Veselina Marinkovića br. 4
31000 UŽICE

Mesto pregleda i
provere:

Zgrada zavoda, prostorija br. 46, prostorija br. 43 i
prostorija za odlaganje otpada
Dr. Veselina Marinkovića br. 4
31000 UŽICE


Naziv dokumenta:

STRUČNI NALAZ
O IZVRŠENOM PREGLEDU I PROVERI OPREME
ZA RAD SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA
NA RADU

Osnov provere:

Na osnovu Vašeg zahteva, čl. 15 tačka 7 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS” br. 101/05 i 91/15 i 113/2017-192-dr. zakon), a u smislu čl. 2 i 3 Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Sl. glasnik RS” br. 94/06, 108/06, 114/2014 i 102/15) i Licence Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 164-02-00095/2021-01 od 29.03.2021. godine.

4. AUTOKLAV - PARNI STABILIZATOR

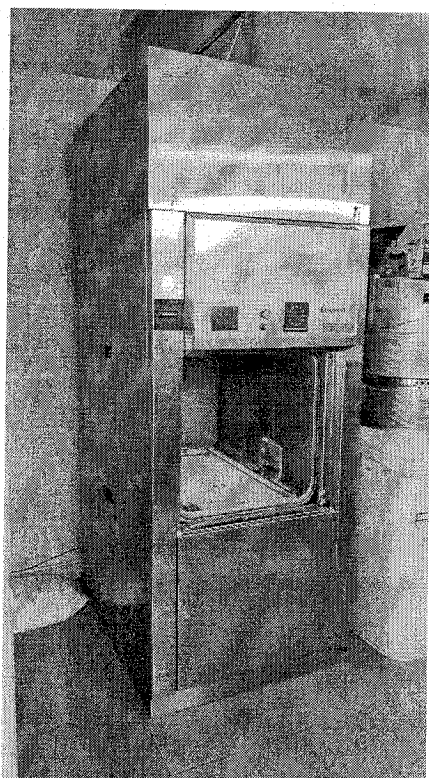

OPŠTI PODACI:	
Proizvođač:	"BELIMED"
Tip:	MST-V 6-6-9 VS1
Fabrički broj:	12134/2010
Godina proizvodnje:	2010
Lokacija:	Prostorija za tretman otpada, suteran
Tehničke karakteristike:	
Napon:	400 V, 50 Hz
Snaga:	3000 W
Najveći radni pritisak:	2,7 bar

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:

Na uvid je dostavljena sledeća tehnička dokumentacija:

- uputstvo za upotrebu i bezbedan rad odgovara
- uputstvo za održavanje..... odgovara
- na uvid dati izveštaji o izvršenim ispitivanjima podeljenosti ventila
sigurnosti (VSPP 0961/23; VSPP 0962/23 i VSPP 0963/23 od 14.02.2023.,
izdatim od strane Termoenergetik plus d.o.o.)..... odgovara

MEHANIČKA I TEHNIČKA ZAŠTITA – NALAZ:

Pregled opreme:

- radni prostor opreme, postavljanje(konstrukcija) opreme..... odgovara
- mehanička zaštita opasnog radnog prostora..... odgovara
- način stavljanja opreme u naponsko stanje..... odgovara
- elektro elementi (ispravnost, mehanička zaštita, zaštita od direktnog dodira)..... odgovara
- zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i previsokog napona..... odgovara

Provera opreme:

Provera upravljačkih uređaja:

- konstruktivna i funkcionalna ispravnost upravljačkih uređaja..... odgovara
- ispravnost upravljačkih uređaja s obzirom na oznake namene..... odgovara
- usaglašenost namene upravljačkog uređaja sa dejstvom zadane funkcije..... odgovara

Provera zaštitnih uređaja i zaštitnih blokada:

- ispravnost zaštitnih blokada..... odgovara
- zaštita od pada i nestanka napona..... odgovara

Provera zaštite od indirektnog dodira:

Zaštita od indirektnog napona dodira je izvedena automatskim isključenjem napajanja, razvodnim sistemom TN-C-S i odgovarajućim osiguračima.

Izmerena je vrednost otpora zaštitnog strujnog kruga $R_p = 0,45 \Omega$ odgovara

PRIMEDBE - NEDOSTACI: Pregledom i ispitivanjem nisu utvrđeni nedostaci.

Na osnovu izvršenog pregleda i provere ispravnosti donet je sledeći

ZAKLJUČAK

da **AUTOKLAV ISPUNJAVA** zahteve propisane važećim tehničkim propisima i standardima i na njemu **SU PRIMENJENE** propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Korišćeni instrument:

1. Višefunkcijsko merilo za proveru mera zaštite u elektrotehnici:

Proizvođač: GOSSEN METRAWATT


Tip: PROFITEST MPRO

Serijski broj: M520N CJ1067


Godina proizvodnje: 2018

Lica koja su vršila pregled i proveru:

Zoran Karan, dipl.inž.maš.




Dragan Stanojević, dipl.inž.el..



Odgovorno lice:

Milorad Budnić, dipl.inž.maš.



(Potpis)